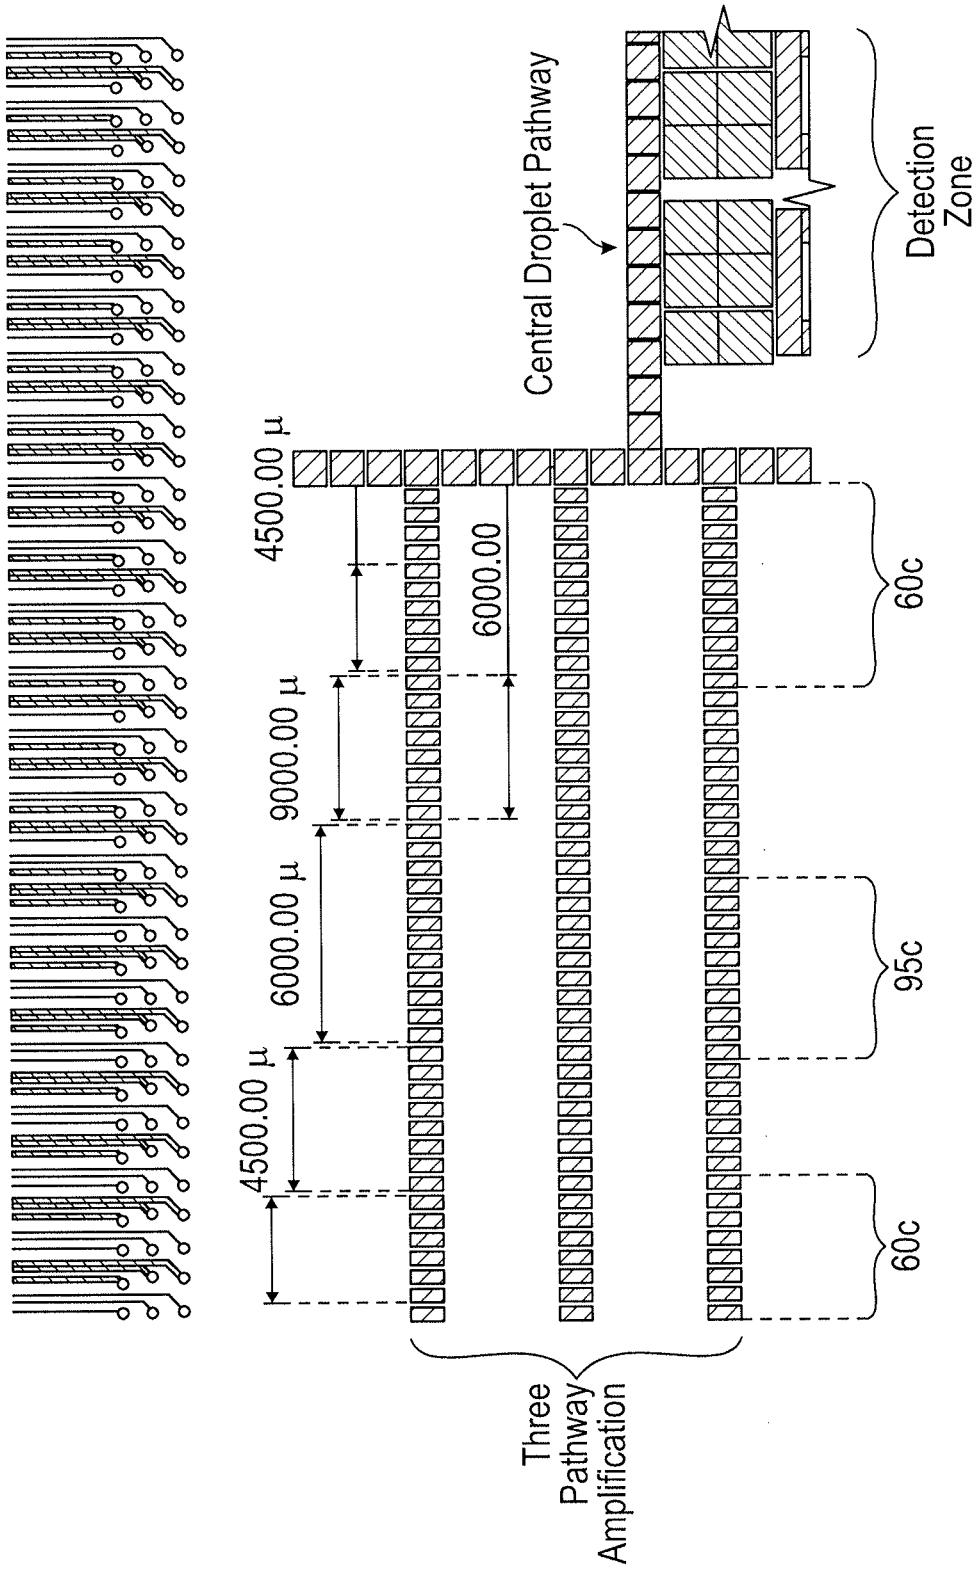
Central Droplet Pathway
Detection Zone
4500.00 µ
6000.00
9000.00 µ
6000.00 µ
4500.00 µ
60c
95c
60c
Three Pathway Amplification

FIG. 34